




Art. 15.97
Standardhebetuch



Art. 15.95A
Hebetuch für
beidseitig Amputierte



Art. 15.95T
Hebetuch Kuvertierung
für Tower Lift



Art. 15.95E
Achselhebetuch
mit Beinhebetuch
getrennt



Art. 15.94
Liegetuch



Art. 15.95
Hebetuch mit
Kopfteil

Nutzbar für Lifter der Klassen: A - B - D - E

Material: Polyester + PU

NUTZERGEWICHT MAX:

150Kg 170Kg 200Kg

Von offenen Flammen fernhalten

Für Reinigung und Desinfektion:
H2O + Neutrale Seife
H2O + ALKOHOL 50%

40°

Ersatzteilnummer :

15.97 15.94

15.95 15.95E

15.95A 15.95C

15.95A-DX 15.95A-SX

Grösse:


M L XL XXL

ACHTUNG:
GEBRAUCHSANWEISUNG LESEN!




VASSILLI

Genahtes Etikett auf dem Hebetuch

UM ZU MONTIEREN

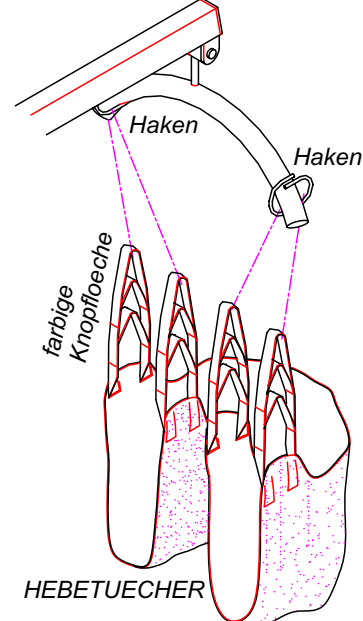

Anbringen das hebetuch am Patient und anstecken die Knopfloche auf die 2 Haken der Halterung. Das Hebetuch ist mit Guertel (3 verschiedene Farben) begabt, die mit 3 Hoehenmasse der Notwendigkeitgemaess uebereinstimmen. Vergewissern sich immer die Knopfloche mit selber Farbe anhaengen, um aus dem Gleichgewicht nicht zu bringen. Es ist genug die Knopfloche angemessen anzuhaengen waehlen, um das Hebetuch der Patienterfordernisse anzupassen.



Einstecken den Gurt in der ersten Extremitaet; dann einstecken den 2 Gurtel in der zweiten Extremitaetvom Haken.

REINIGUNG UND DESINFEKTION DER LIFTERGURTE/-TÜCHER

Die Liftergurte/-tücher müssen regelmäßig insbesondere bei Nutzerwechsel gereinigt werden:

- Wasser mit 40° gemischt mit neutraler Seife.
- Wasser mit 40° mit Alkohol 50%.

Liftergurte/-tücher nicht bügeln oder anderweitig großer Hitze aussetzen !
ACHTUNG!! Vor jeder Nutzung der Liftergurte/-tücher prüfen Sie deren Unversehrtheit. Bei irgendwelchen Schäden tauschen Sie die Gurte/Tücher gegen neue. Die Firma Vassilli übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung, wenn andere als die Original Vassilli Liftergurte/-tücher verwendet wurden.

DER LIFTER DARF NUR WIE BESCHRIEBEN GENUTZT WERDEN!

CE Konformitätserklärung (Direktive 2007/47/CE)

ALLE IN DIESEM HANDBUCH BESCHRIEBENEN PRODUKTE SIND KONFORM MIT DER DIREKTIVE 2007/47/CE. DIE KONFORMITÄT MIT DER DIREKTIVE WIRD ERKLÄRT FÜR DIE KONSTRUKTION NACH DEN ALLGEMEINEN ANFORDERUNGEN UND DEN HARMONISIERTEN TESTREGELN:

- EN 12182 "Hilfsmittel für Behinderte - Allgemeine Anforderungen und Testregeln"
- EN ISO 10535 "Lifter für den Transfer Behinderter - Allgemeine Anforderungen und Testregeln"



Der Verantwortliche für die Konformität